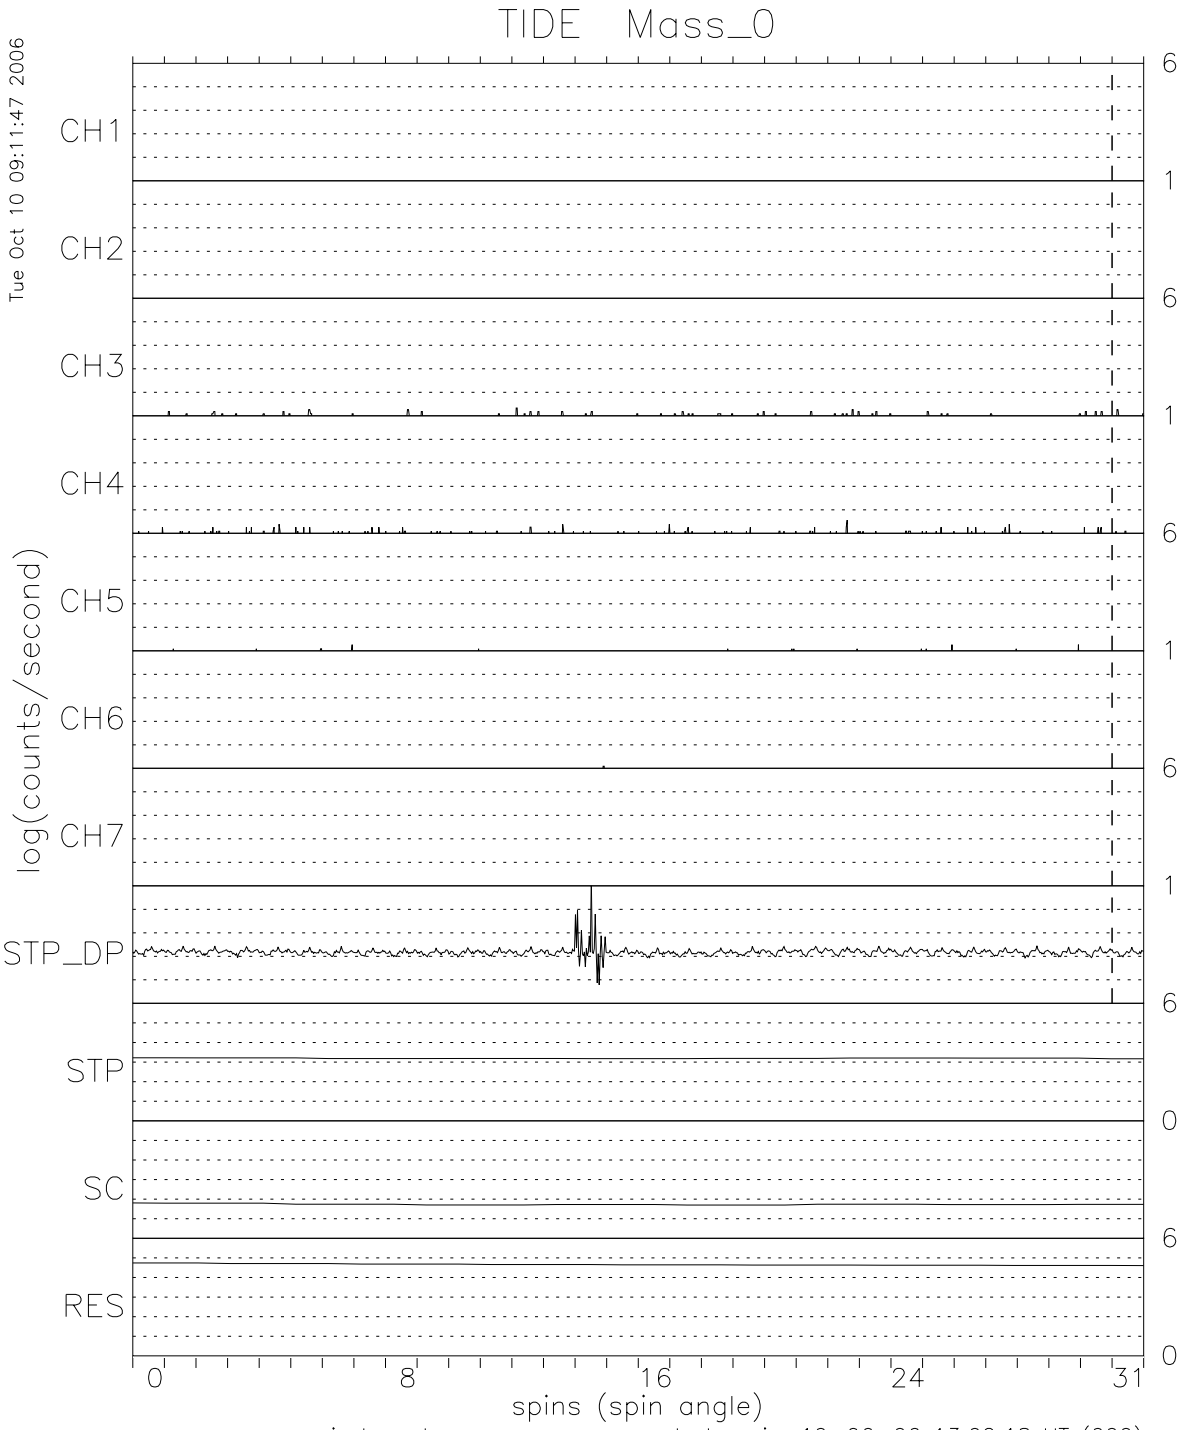

file: /export/data/tide/nrt/06100601.dat

−15kV TOF:	−9245 v
−3.6kV MCP:	−3364 v
−2.4kV MCP:	−1784 v
Input Cur:	308 ma
RPA max:	237 v
Mirror max:	238 v

Tue Oct 10 09:11:48 2006

TIDE Direct Events

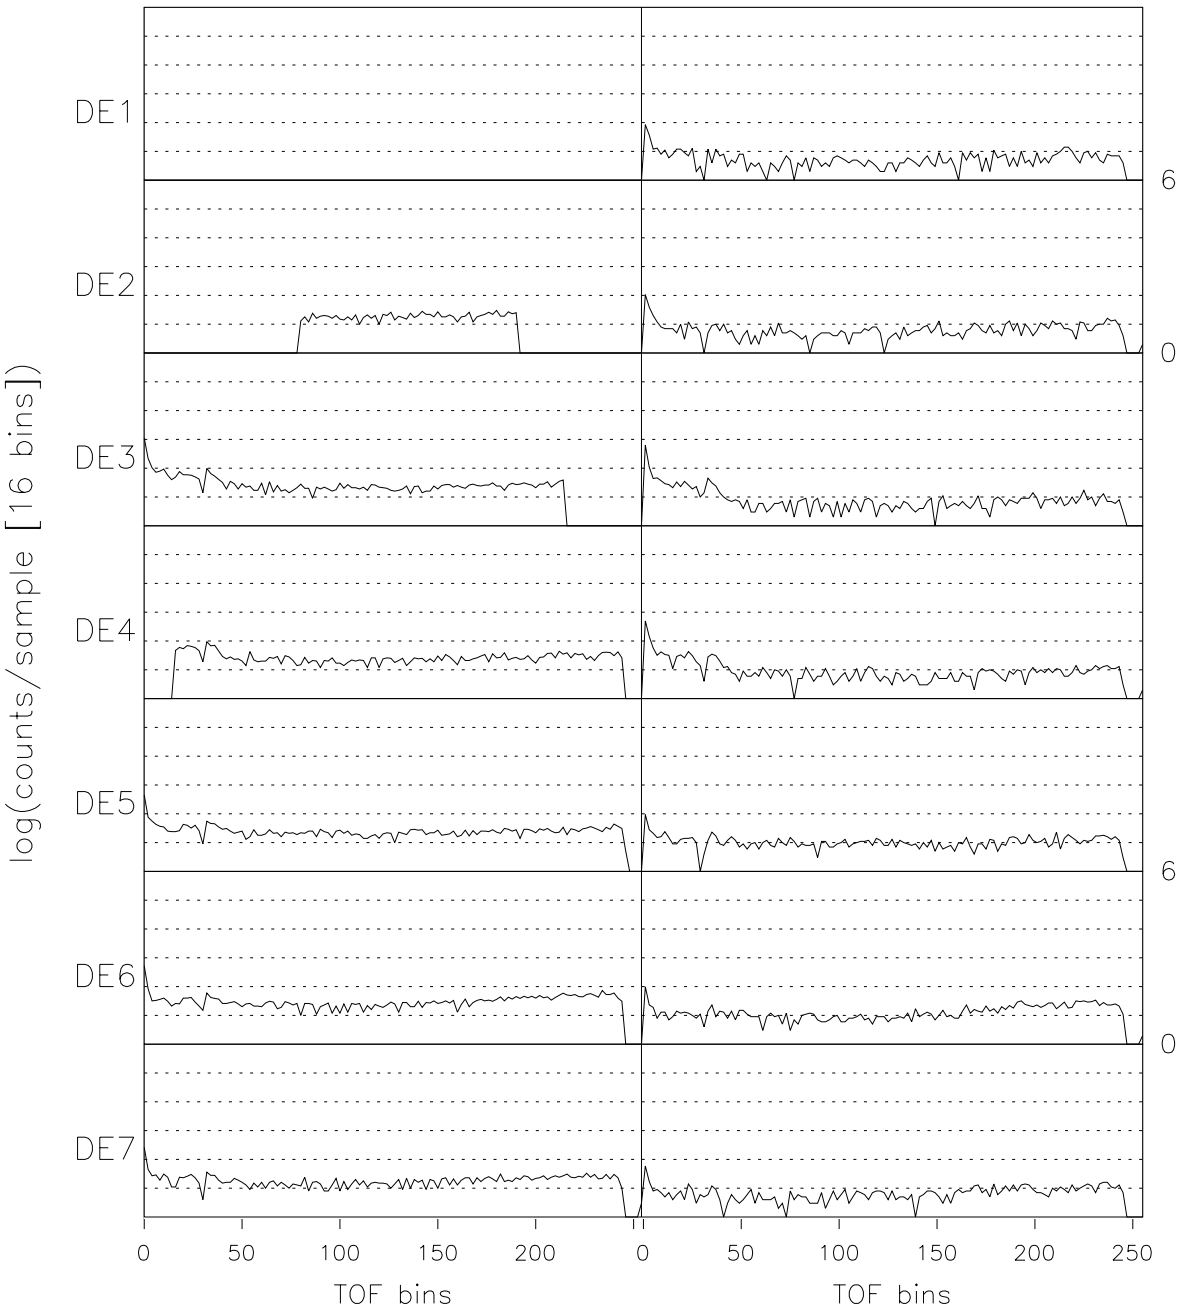

reported: 10-06-06 12:55:48 UT

reported: 10-06-06 12:59:00 UT

file: /export/data/tide/nrt/06100601.dat

−15kV TOF:	−9116 v
−3.6kV MCP:	−3379 v
−2.4kV MCP:	−1784 v
Input Cur:	298 ma
RPA max:	237 v
Mirror max:	238 v