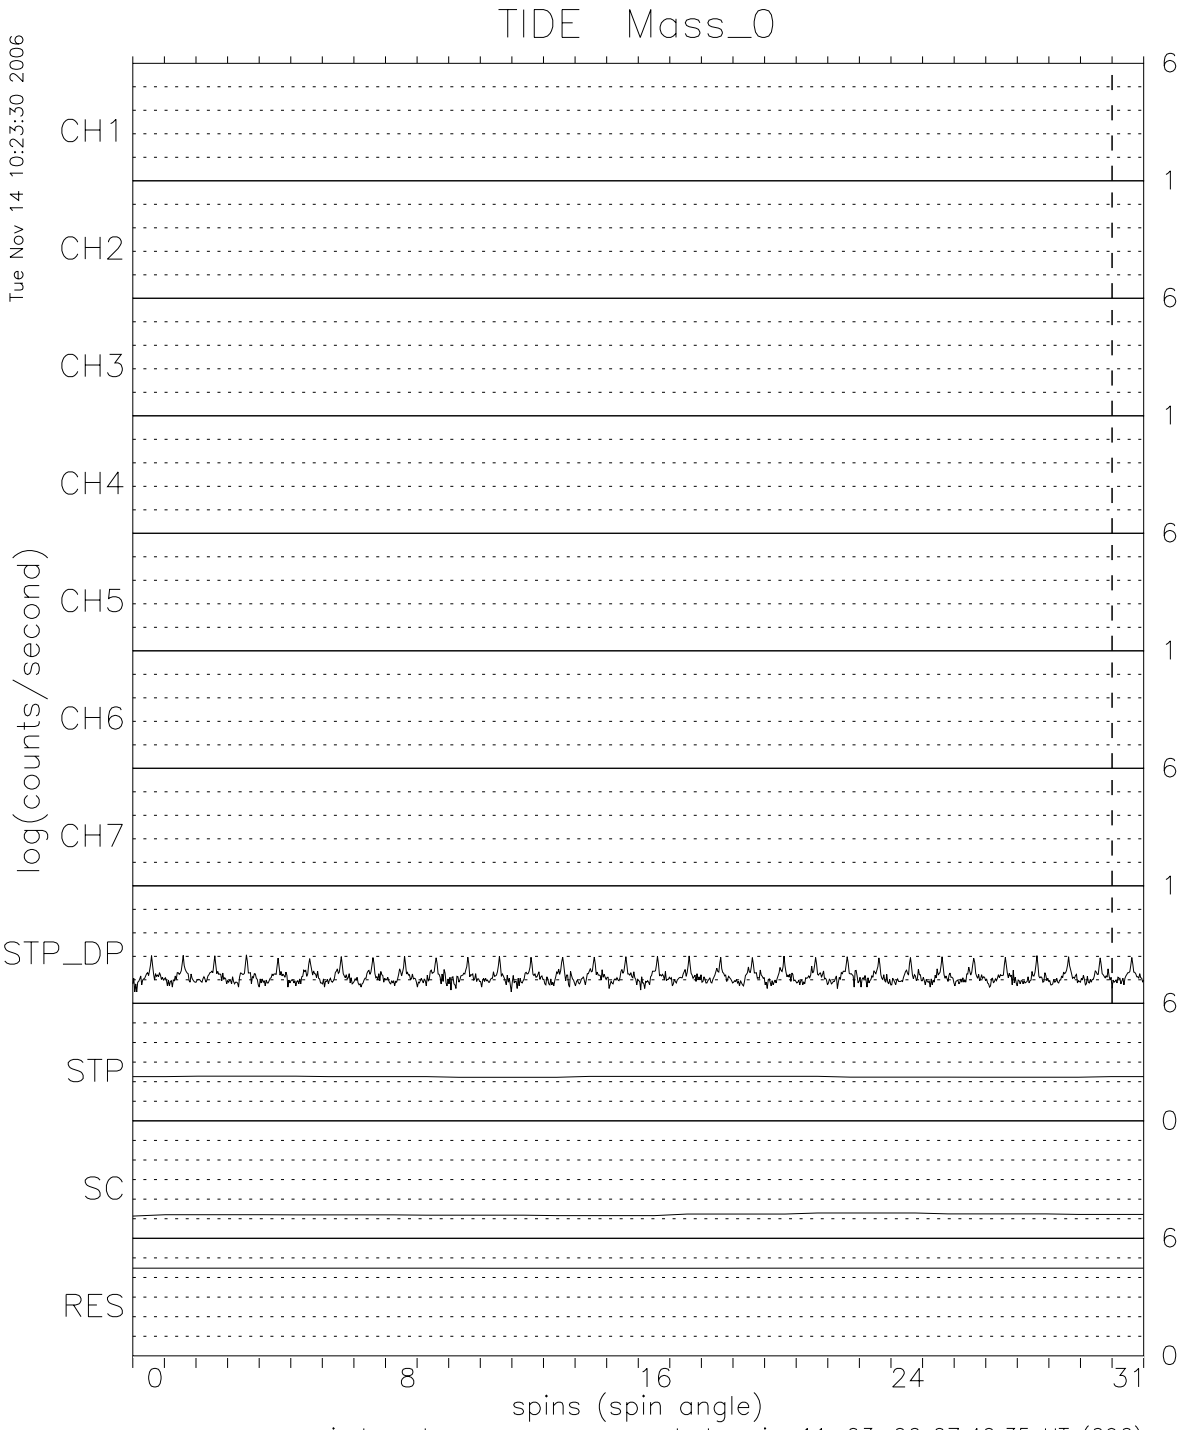

file: /export/data/tide/nrt/06110301.dat

−15kV TOF:	−9181 v
−3.6kV MCP:	−3379 v
−2.4kV MCP:	−1774 v
Input Cur:	310 ma
RPA max:	237 v
Mirror max:	238 v

Tue Nov 14 10:23:31 2006

TIDE Direct Events

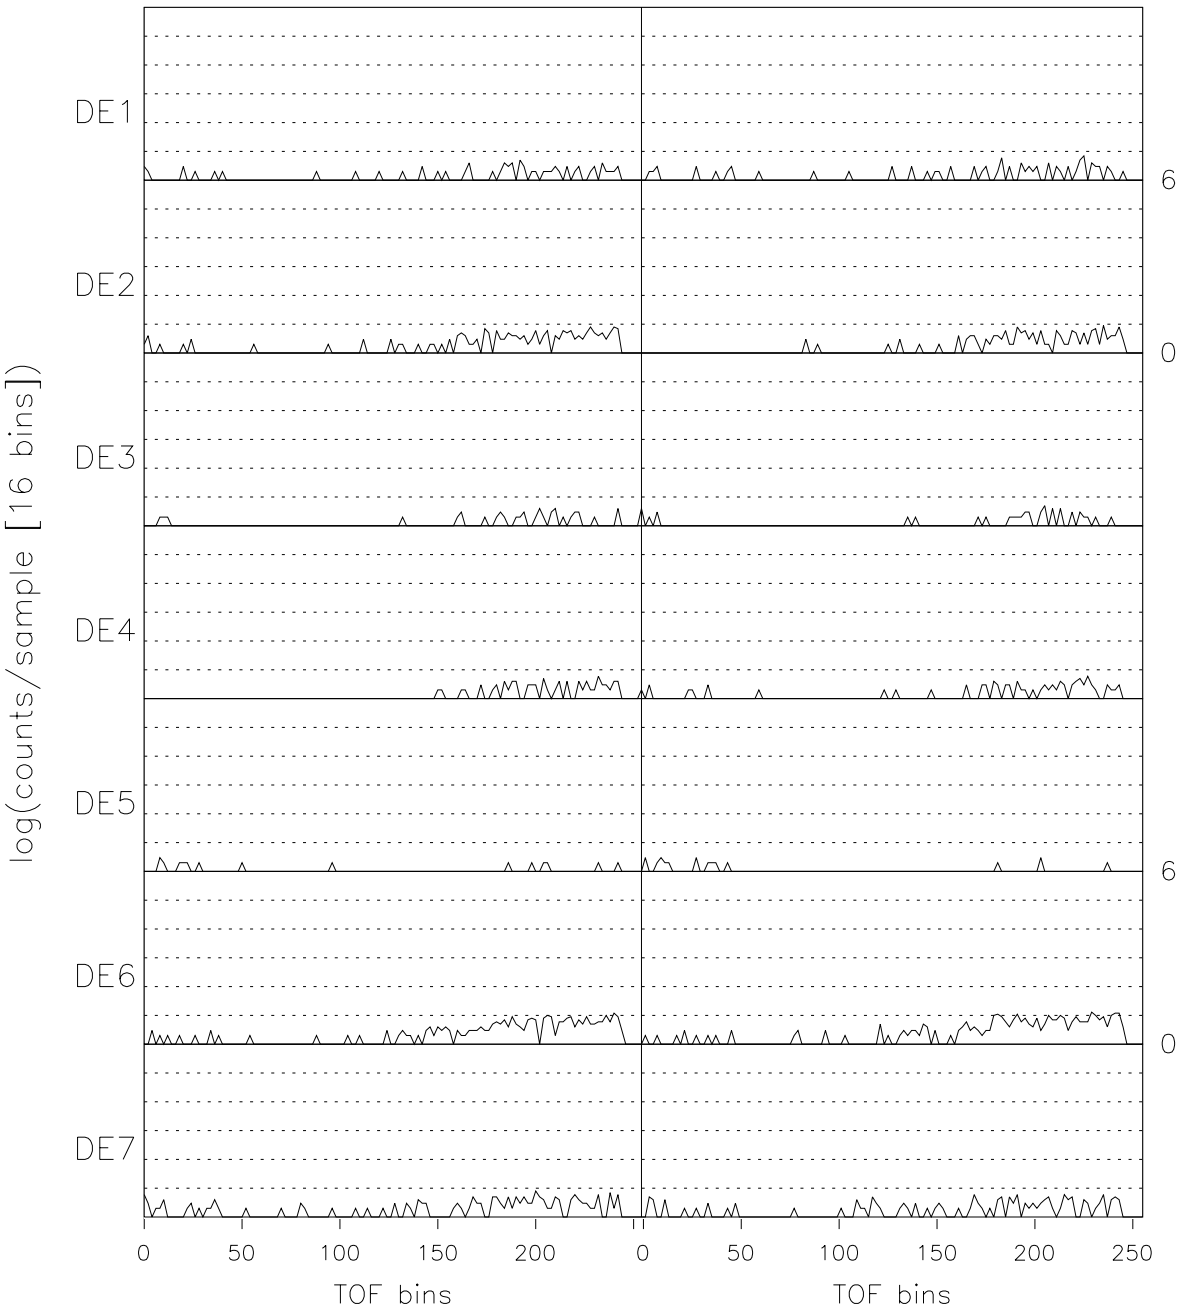

reported: 11-03-06 07:34:05 UT

reported: 11-03-06 07:37:17 UT

file: /export/data/tide/nrt/06110301.dat

-15kV TOF:	-9245 v
-3.6kV MCP:	-3364 v
-2.4kV MCP:	-1774 v
Input Cur:	310 ma
RPA max:	237 v
Mirror max:	238 v