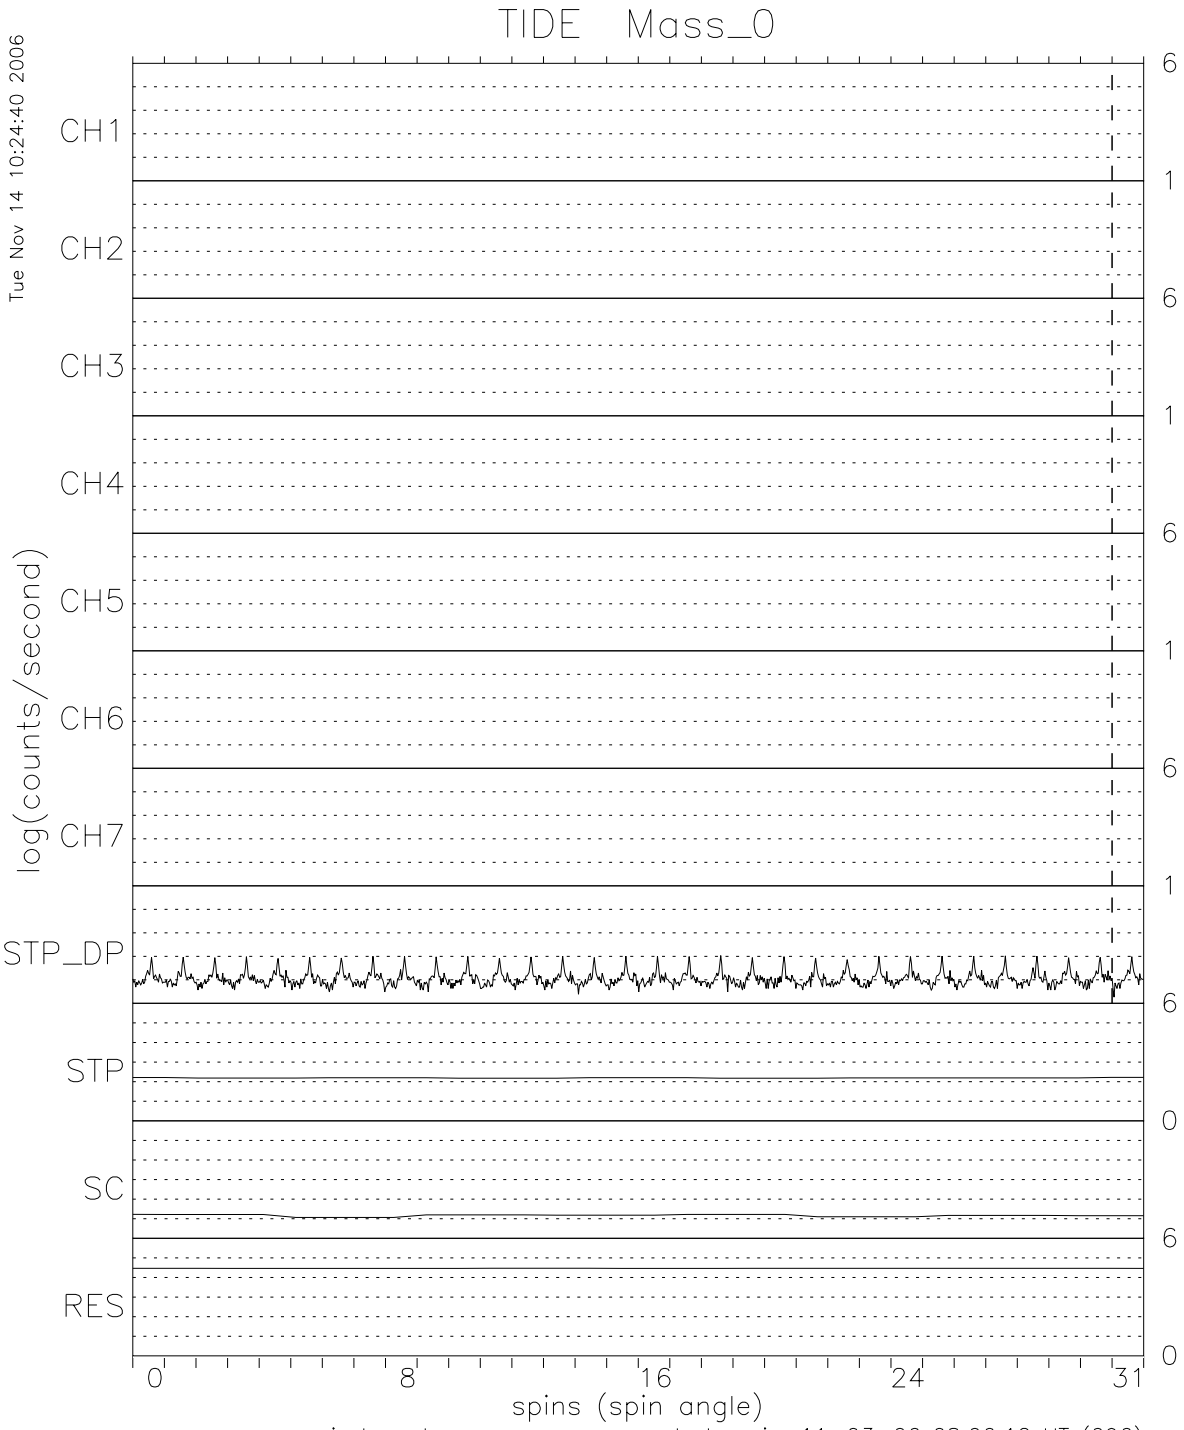

file: /export/data/tide/nrt/06110301.dat

−15kV TOF:	−9245 v
−3.6kV MCP:	−3364 v
−2.4kV MCP:	−1784 v
Input Cur:	310 ma
RPA max:	237 v
Mirror max:	238 v

Tue Nov 14 10:24:40 2006

TIDE Direct Events

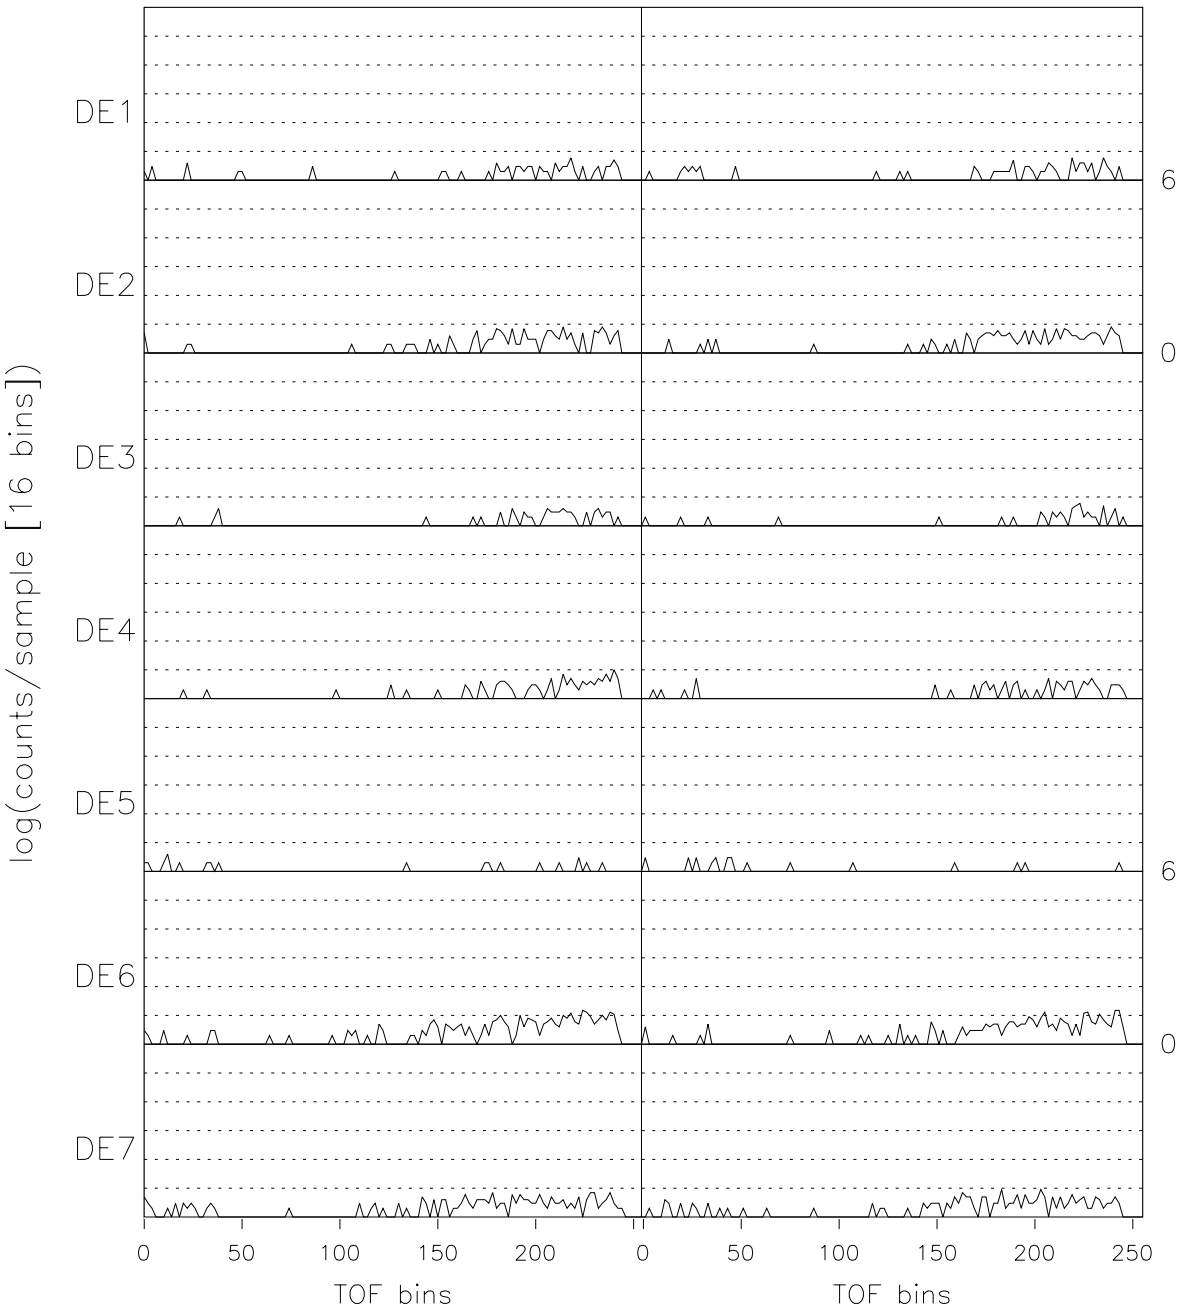

reported: 11-03-06 07:59:42 UT

reported: 11-03-06 08:02:54 UT

file: /export/data/tide/nrt/06110301.dat

−15kV TOF:	−9245 v
−3.6kV MCP:	−3379 v
−2.4kV MCP:	−1774 v
Input Cur:	318 ma
RPA max:	237 v
Mirror max:	238 v